


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22



UNIVERSITAS ANDALAS

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMELIHARAAN PERALATAN
MEDIS DI RSUD dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021**

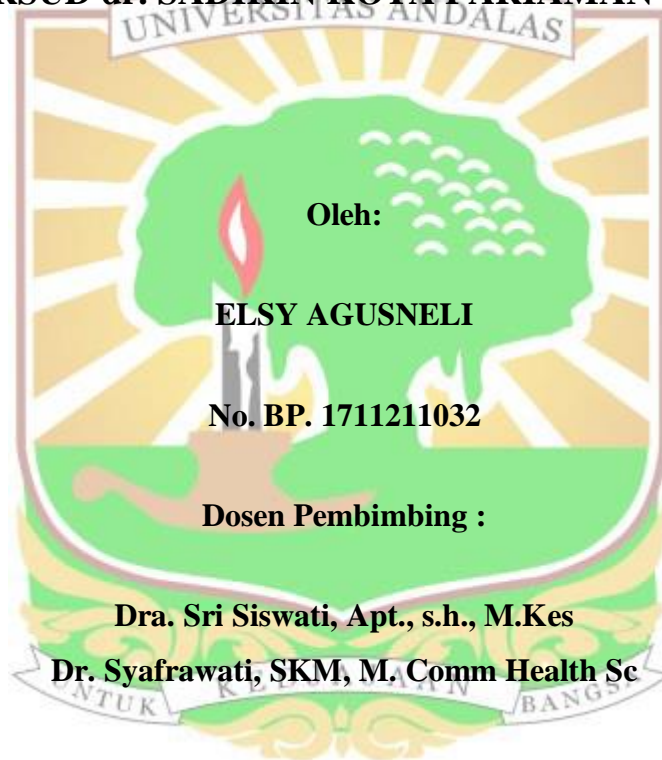

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2021

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

23 **Skripsi, November 2021**

24

25 **ELSY AGUSNELI, No.Bp : 1711211032**

26

27 **ANALISIS PELAKSANAAN PEMELIHARAAN PERALATAN MEDIS DI**
28 **RSUD dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021”**

29

30 **xiii + 133 halaman, 29 tabel, 2 gambar, 14 lampiran**

31

32 **ABSTRAK**

33

34 **Tujuan**

35 Peralatan medis yang rusak di RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman tahun 2020
36 sebanyak 14,72 % alat, yang mengakibatkan keterlambatan dalam memberikan
37 pelayanan kepada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan
38 pemeliharaan peralatan medis di RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman Tahun 2021.

39 **Metode**

40 Desain penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di RSUD dr. Sadikin
41 Kota Pariaman pada Juni-November 2021 dengan 7 informan, menggunakan teknik
42 *purposive sampling*. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi,
43 dan telaah dokumen. Data diolah melalui reduksi data, penyajian dan penarikan
44 kesimpulan, kemudian dilakukan triangulasi sumber dan metode.

45 **Hasil**

46 Didapatkan bahwa teknisi belum mendapatkan motivasi kerja, kurangnya dana
47 mengakibatkan 22,59% alat belum dikalibrasi, bangunan IPSRS belum sesuai
48 standar, sosialisasi SOP kepada *user* tidak merata. Proses indikator pemeliharaan
49 preventif tidak terlaksana. Perbaikan secara korektif dan tidak terencana mengalami
50 keterlambatan. *Output* pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis di RSUD dr.
51 Sadikin sudah terlaksana namun belum maksimal.

52 **Kesimpulan**

53 Pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis di RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman
54 sudah terlaksana namun belum maksimal dikarenakan pemeliharaan secara preventif
55 belum dilakukan. Diharapkan kepada pihak IPSRS RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman
56 melaksanakan pemeliharaan secara preventif, agar kegiatan pemeliharaan berjalan
57 dengan optimal.

58 **Sumber** : 37 (2001-2020)

59 **Kata Kunci** : Pelaksanaan pemeliharaan, Peralatan medis, *input*, proses, *output*

**FACULTY OF PUBLIC HEALTH
ANDALAS UNIVERSITY**

Undergraduate Thesis, November 2021

ELSY AGUSNELI, No.Bp : 1711211032

**ANALYSIS OF MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE IN RSUD dr.
SADIKIN KOTA PARIAMAN IN 2021**

xiii + 133 pages, 29 tables, 2 pictures, 14 appendix

ABSTRACT

Objective

Damage to medical equipment in RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman in 2020 as many as 14.72% of tools, which resulted in delays in providing services to patients. This study aims to analyze the maintenance of medical devices in RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman in 2021.

Method

Conducted at Sadikin Kota Pariaman in June-November 2021 with 7 informants, using purposive sampling technique. The data is processed through data reduction, presentation and conclusion drawing, then triangulation of sources and methods is carried out.

Result

Technicians have not received work motivation, lack of funds resulted in 22.59% of equipment not being calibrated, IPSRS buildings have not met the standards, SOP socialization has not been evenly distributed! The process of preventive maintenance indicators is not implemented, corrective and unplanned repairs experience problems Output from the implementation of maintenance of medical devices in RSUD dr. Sadikin has been implemented but not optimal.

Conclusion

Implementation of maintenance of medical devices in RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman has been implemented, but preventive maintenance has not been maximized. IPSRS is expected to carry out preventive maintenance so that maintenance runs optimally.

References : 37 (2001-2020)

Keywords : Implementation of maintenance, medical equipment, IPSRS, input, process, output.